

检测报告

NBF25-0001484-01

发布日期: 2025-01-26

客户名称: 帕柯斯健康产业(吉林)有限公司
客户地址: 吉林省长春市朝阳区融大天玺项目 2306 房间

样品名称: 帕柯斯雾化护眼仪抗菌硅胶按摩头
样品批号: /
生产日期: /
生产商: /

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

样品接收日期: 2025-01-20
检测周期: 2025-01-20 ~ 2025-01-26
检测方法: 请参见下一页。
检测结果: 请参见下一页。



SGS 授权签字人

扫码查看在线报告



NBF25-0001484-01
报告验证请访问:
check.sgsonline.com.cn

通标标准技术服务有限公司宁波分公司
第 1 页, 共 3 页

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



No.1177 Lingyun Road, Ningbo Hi-Tech Zone, Ningbo, China 315040
中国·浙江·宁波高新区凌云路1177号 邮编: 315040

t 400-691-0488 www.sgsgroup.com.cn
t 400-691-0488 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

NBF25-0001484-01

发布日期: 2025-01-26

检测样品描述:

样品编号	SGS 样品 ID	样品描述
1	NBF25-0001484-0001	袋装物

检测结果:

检测要求: 根据申请者的要求: 抗菌效果实验

检测方法: ISO 22196:2011 塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定

NBF25-0001484-0001

检测菌种	大肠杆菌 ATCC 8739
接种菌液浓度 (CFU/mL)	5.0×10^5
接种菌液量 (mL)	0.4
U_0	4.08
U_t	5.96
A_t	-0.20
B (CFU/cm ²)	9.1×10^5
C (CFU/cm ²)	<0.63
抗菌活性值 R	6.2
*抗菌率 (%)	>99.9

检测菌种	金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P
接种菌液浓度 (CFU/mL)	4.0×10^5
接种菌液量 (mL)	0.4
U_0	3.95
U_t	5.81
A_t	-0.20
B (CFU/cm ²)	6.4×10^5
C (CFU/cm ²)	<0.63
抗菌活性值 R	6.0
*抗菌率 (%)	>99.9

备注:

- 未处理对照样为无抗菌性能塑料膜, 由 SGS 实验室提供。
- U_0 : 未处理对照样在 0 h 接触时间洗脱后获得的细菌数(CFU/cm²)的对数值。
- U_t : 未处理对照样在 24 h 接触时间洗脱后获得的细菌数(CFU/cm²)的对数值。
- A_t : 样品在 24 h 接触时间洗脱后获得的细菌数(CFU/cm²)的对数值。
- *抗菌率(%)计算公式为 **【(B-C)/B】x100%**;
B: 未处理对照样接种后 24 h 的菌数的平均值(CFU/cm²);
C: 样品接种后 24 h 的菌数的平均值(CFU/cm²)。
- 样品前处理: 用 70%酒精拭擦样品表面, 无菌水冲洗, 自然晾干。

通标标准技术服务有限公司宁波分公司

第 2 页, 共 3 页

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



No.1177 Lingyun Road, Ningbo Hi-Tech Zone, Ningbo, China 315040
中国·浙江·宁波高新区凌云路1177号 邮编: 315040

t 400-691-0488 www.sgs.com.cn
t 400-691-0488 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)




检测报告

NBF25-0001484-01

发布日期: 2025-01-26

样品照片:

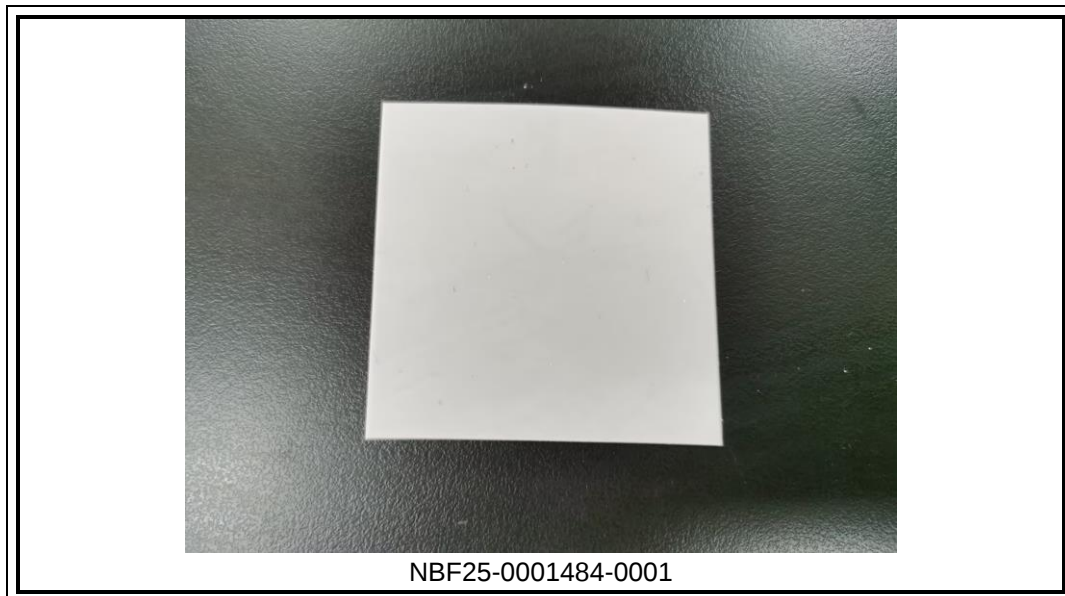

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

注意事项:

除非另有说明, 本检测结果仅与被检测物品有关。未经检验机构书面同意, 委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。本检测报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用。未经检验机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告。

结束



通标标准技术服务有限公司宁波分公司
第 3 页, 共 3 页

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.1177 Lingyun Road, Ningbo Hi-Tech Zone, Ningbo, China 315040
中国·浙江·宁波高新区凌云路1177号 邮编: 315040

t 400-691-0488 www.sgsgroup.com.cn
t 400-691-0488 sgs.china@sgs.com

